


# 523实验室设置

725-23配压阀用于1500和1600型压力膜仪

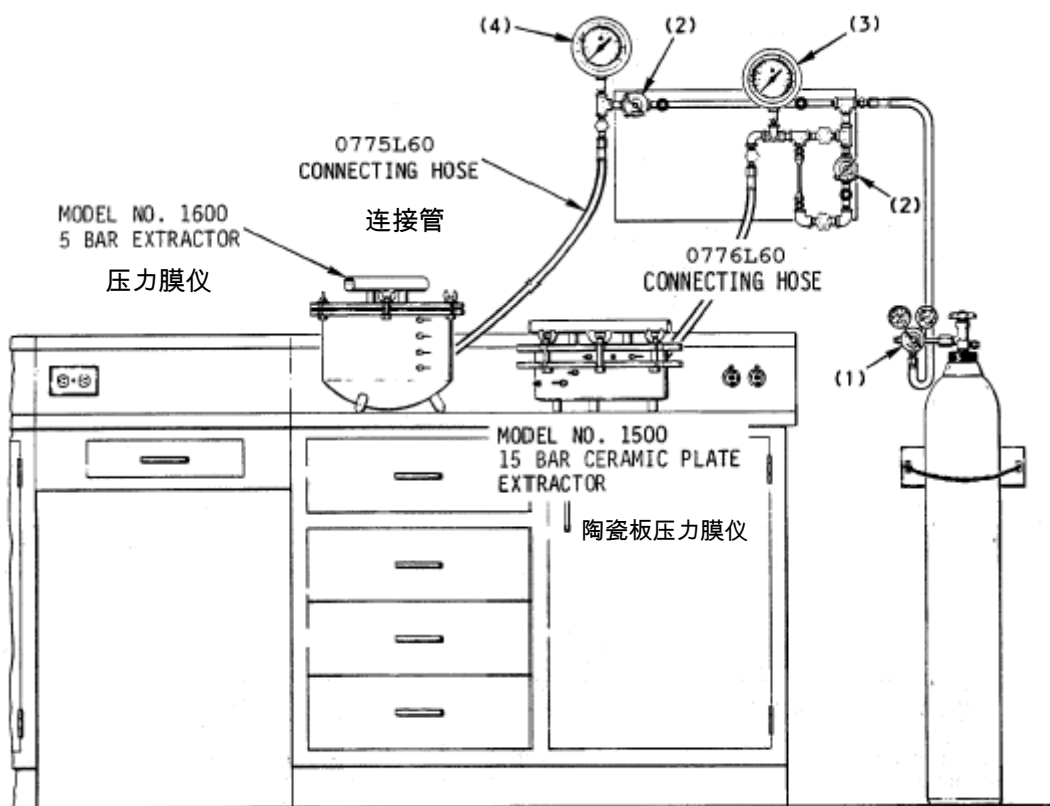

750-23型配压阀组成：

- (1) 767P0500G1调节器
- (2) 2个0766P0125调节器
- (3) 780P0300 测试量表范围 0-300psi
- (4) 0780P0060测试量表范围 0-60psi

所有必要的阀门和配件

实验室设置是用氮罐为1600型5-巴压力膜仪和1500型15-巴陶瓷板压力膜仪独立提供压力。

---

仪器目录和一般附件：

---

1件	1500	15巴陶瓷板压力膜仪
1件	1080G1	PM铰链
1件	1081	适配板
1件	0775L60	连接管
4打	1093	放样圈 ( 每打12个 )
1件	1600G1	5巴压力膜仪和4个0675B01M1 ,1巴压力板
4件	0675B3M1	3巴压力板
1件	0776L60	连接管
1件	0750CG23	配压阀