


# 053实验室设置

## 0750G3配压阀 3/93用于1600 5-巴压力膜仪

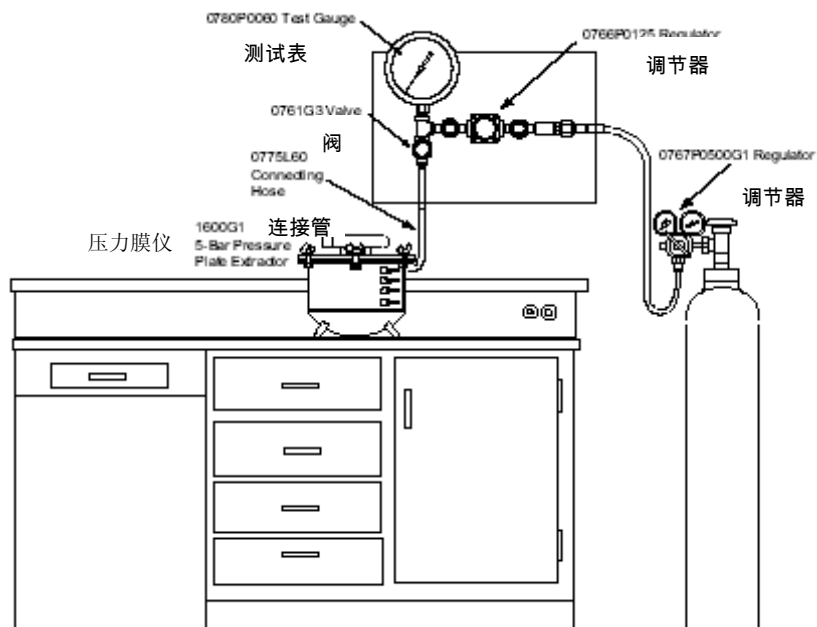

### 0750G3配压阀组成

- ( 1 ) 0767P0500G1调节器，0-500psi
- ( 2 ) 0766P0125调节器，0-125psi
- ( 3 ) 0780P0060，测试量表，0-60psi
- ( 4 ) 0761G3阀

### 仪器目录和一般附件：

1件	1600G1	5-巴压力膜仪，4个0675B03M1，5巴压力板
1件	0776L60	连接管，60英寸长
4打	1093	放样圈（每打12个）
4件	0675B03M1	3巴压力板
1件	0750G3	配压阀