


# 123实验室设置

0700CG123配压阀 6/2002用于1000压力膜仪、1500和1600压力膜仪

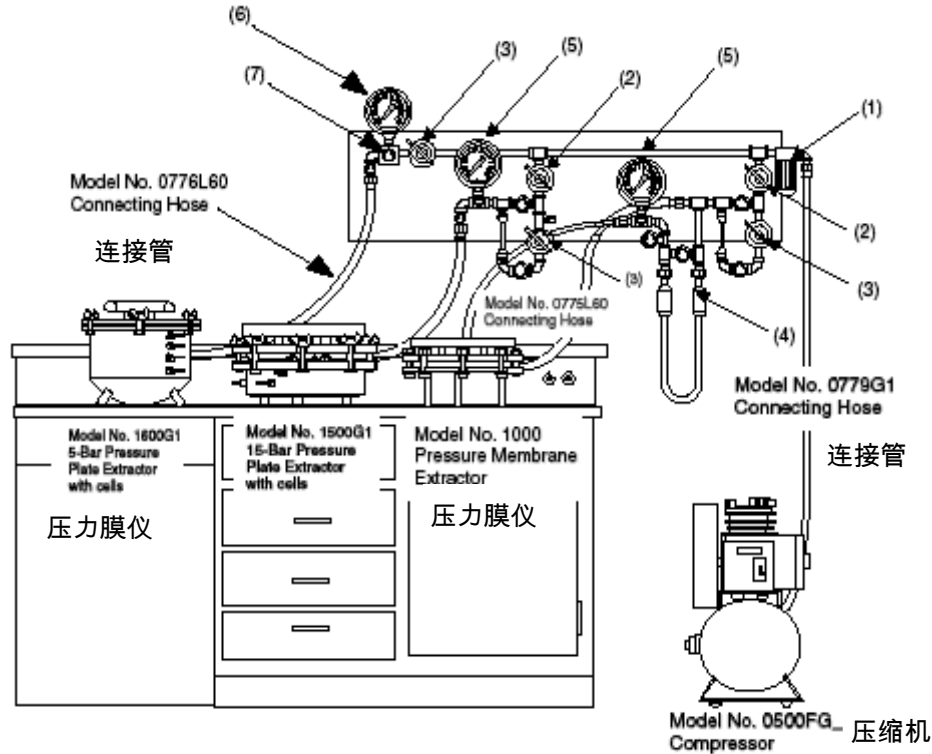

## 0700CG123配压阀组成：

- (1) 0760G1空气过滤器
  - (2) 2个0766P0250调节器，0-250psi
  - (3) 3个0766P0150调节器，0-150psi
  - (4) 0769G2水银微调节器
  - (5) 2个0780P0300测试量表，2，0-300psi
  - (6) 0780P0060测试量表，0-60psi
  - (6) 0765自动置零调节器，0-60psi
- 加上所有必要的阀和装置

---

仪器订购单和一般附件：

1件	1000	压力膜仪
1件	1080G1	PM铰链
1件	1090	扭矩扳手和插槽
1件	0775L60	连接管，60英寸长
6打	1093	放样圈（每打12个）
6件	1041D12	切纤维膜的圆盘
1件	1500	15-巴压力膜仪
3件	0675B15M1	15巴压力板
1件	01080G1	PM铰链
1件	0775L60G1	连接管，60英寸长
1件	1600	5巴压力膜仪
4件	0675B01M1	1巴压力板
4件	0675B03M1	3巴压力板
1件	0776L60	连接管，60英寸长
1件	0700CG123	配压阀
1件	0779G1	连接管，组合，60英寸长
1件	0500FG	PM压缩机